

suiteDXT

Instructions d'utilisation

NeoSoft, LLC

NEOSOFT

NS-03-043-0004-FR Rév. 1
Copyright 2022 NeoSoft, LLC
Tous droits réservés

Historique des révisions

Rév.	Date	Description de la modification	Actualisation relative à la sécurité (Oui/Non)
1	15 JUILLET 2022	Mise à jour pour la version 5.1.0 du produit. Ajout du portugais brésilien Ce mode d'emploi remplace les précédentes révisions/langues/pièces portant les numéros suivants : suiteDXT IFU - NS-03-039-0008, EN-Rev. 7 suiteDXT IFU - NS-03-039-0009, FR-Rev. 6 suiteDXT IFU - NS-03-039-0010, DE-Rev. 6 suiteDXT IFU - NS-03-039-0011, IT-Rev. 6 suiteDXT IFU - NS-03-039-0012, EL-Rev. 6 suiteDXT IFU - NS-03-040-0009, LT - Rev. 5 suiteDXT IFU - NS-03-040-0010, ES - Rev. 5 suiteDXT IFU - NS-03-040-0011, SV - Rev. 5 suiteDXT IFU - NS-03-040-0012, TR - Rev. 5 suiteDXT IFU - NS-03-040-0013, RO - Rev. 5 suiteDXT IFU - NS-03-040-0014, NL - Rev. 5 suiteDXT IFU - NS-03-040-0029, PT-PT - Rev. 4 suiteDXT IFU - NS-03-041-0008, ZH-CN - Rev. 2 suiteDXT IFU - NS-03-041-0010, HU - Rev. 3 suiteDXT IFU - NS-03-042-0008, JA - Rev. 1 suiteDXT IFU - NS-03-042-0009, VI - Rev. 1	Non

Fabricant



NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072, États-Unis

Téléphone : 262-522-6120
Site Web : www.neosoftllc.com

Vente : orders@neosoftmedical.com
Assistance technique : service@neosoftmedical.com

Les instructions d'utilisation de ce dispositif sont fournies en version électronique au format PDF. Une visionneuse PDF est nécessaire pour consulter les instructions d'utilisation. Une version imprimée des instructions d'utilisation est disponible gratuitement dans un délai de 7 jours en soumettant une demande par e-mail à l'adresse suivante : service@neosoftmedical.com.

Les instructions d'utilisation sont accessibles des manières suivantes :

- Après le lancement de l'application, cliquer sur « Aide » ou « À propos » sur l'écran principal. Sélectionnez l'option « Instructions d'utilisation ». Les Instructions d'utilisation s'ouvriront dans une visionneuse PDF.
- Si le package d'installation original de NeoSoft est disponible, ouvrir le fichier Zip et accéder au dossier « Documentation » puis au dossier « Instructions d'utilisation » et double-cliquer sur le fichier « Instructions for Use.pdf » dans votre langue, désignée par EN pour l'anglais, FR pour le français, DE pour l'allemand, EL pour le grec, IT pour l'italien, LT pour le lituanien, ES pour l'espagnol, SV pour le suédois, TR pour le turc, RO - Roumain, NL - Néerlandais, ZH_CN - Chinois simplifié, PT-PT - Portugais, HU - Hongrois, JA - Japonais, VI - Vietnamien, PT-BR - Portugais Brésilien
- Accéder au dossier dans lequel est installée l'application. Dans le dossier « Documentation », ouvrez le dossier « Instructions d'utilisation » et double-cliquez sur le fichier « Instructions for Use.pdf » dans votre langue, désignée par EN pour l'anglais, FR pour le français, DE pour l'allemand, EL - pour le grec, IT - pour l'italien, LT - pour le lituanien, ES - pour l'espagnol, SV - pour le suédois, TR - pour le turc, RO - pour le roumain, NL - pour le néerlandais, ZN_CN pour le chinois simplifié, PT-PT pour le portugais, HU pour le hongrois, JA pour le japonais, VI pour le vietnamien, PT-BR pour le portugais Brésilien.
- Une version électronique des instructions d'utilisation est également disponible à l'adresse www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ pendant au moins 15 ans, à compter de la dernière date de fabrication.
- suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 850001088039.

Réglementation relative aux dispositifs médicaux

Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 relative aux dispositifs médicaux lorsqu'il porte le marquage de conformité CE suivant :



Ce produit est un dispositif médical :	Importateur :



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123,
2595 AM The Hague,
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



Représentant autorisé malaisien :
Emergo Malaysia Sdn. Bhd.
Level 16, 1 Sentral Jalan Stesen Sentral 5 KL
Sentral, 50470
Kuala Lumpur MALAYSIA

Numéro d'enregistrement du dispositif
médical en Malaisie : GB10979720-50888

Canada : Numéro de licence de dispositif de Santé Canada : 99490

suiteDXT 5.1.0 UDI: 008500001088022510



ATTENTION : *La loi fédérale des États-Unis limite la vente de ce dispositif par un médecin ou sur sa commande.*

Tout incident grave survenu en rapport avec cet appareil doit être signalé à NeoSoft et à l'autorité compétente de votre État membre.

Table des matières

Réglementation relative aux dispositifs médicaux i

Sécurité **1**

- Introduction* **1**
- Utilisation prévue* **1**
- Indications d'emploi* **1**
- Formats d'image DICOM pris en charge* **1**
- Terminologie* **2**
- Dangers relatifs aux appareils* **2**

Cybersécurité **3**

Guide de démarrage **5**

- Fonctions de l'écran principal* **5**
- Menu activé avec un clic-droit dans le panneau Études* **6**
- Menu activé par clic droit dans le panneau Série* **6**
- Fenêtre Interrogation/Récupération* **7**
- Menu activé par clic droit dans le volet Interrogation/Résultats* **8**
- Menu activé par clic droit dans le panneau Série* **8**

Utiliser suiteDXT **9**

- Lancer une application* **9**
- Récupérer une étude hébergée sur un hôte distant* **10**
- Récupération automatique d'une étude précédente* **12**
- Envoyer une étude à un hôte distant* **14**
- Envoyer une série à un hôte distant* **14**
- Indicateurs du volet Étude* **15**
- Envoyer des fichiers NeoSoft DICOM* **15**
- Importer une étude* **15**
- Exporter des études* **16**
- Lancer une recherche* **17**
- Créer des dossiers* **17**
- Anonymiser une étude* **18**
- Supprimer une protection* **19**
- Supprimer une étude* **19**
- Supprimer une série* **20**
- Supprimer une série de capture secondaire* **20**
- À propos de suiteDXT* **21**

Prétraitement d'étude **22**

- Configurer le pré-traitement* **22**
- Utiliser le prétraitement* **23**
- Indicateurs du volet Étude* **24**

Virtual Fellow® **25**

- Activer/désactiver Virtual Fellow™* **25**
- Fenêtre Aperçu de l'image* **26**

Assistance technique **27**

- Panne du réseau DICOM* **27**

Erreur de lancement de l'étude **28**
Nous contacter **28**

Sécurité

Introduction

Afin d'assurer une utilisation efficace dans des conditions de sécurité optimales, il est essentiel de lire cet avertissement concernant la sécurité et tous les sujets qui s'y rapportent avant d'utiliser le logiciel. Il est essentiel d'avoir lu et compris l'intégralité de ces instructions avant toute tentative d'utilisation du produit. Il est important de revoir de façon périodique les procédures et précautions de sécurité.

Ce logiciel est destiné à être utilisé uniquement par un personnel formé et qualifié.

Le logiciel suiteDXT a une durée de vie utile de 7 ans, à compter de la date de la version originale.

Utilisation prévue

Le logiciel suiteDXT a été conçu pour permettre aux utilisateurs de gérer la communication en réseau DICOM, le stockage des images DICOM prises en charge, l'importation des images DICOM prises en charge à partir du système de fichier local, d'anonymiser une étude et de lancer les applications d'imagerie associées. Ce logiciel a été conçu pour servir temporairement d'emplacement de stockage.

Indications d'emploi

Le logiciel suiteDXT a été conçu pour permettre aux utilisateurs d'importer, d'exporter et d'anonymiser les images DICOM, ainsi que de lancer les applications d'imagerie associées. Ce produit n'a pas été conçu pour faire fonction ou usage de diagnostic médical.

Formats d'image DICOM pris en charge

Le logiciel suiteDXT prend en charge les formats DICOM suivants : MR et MR amélioré.

REMARQUE : Le logiciel suiteDXT prend en charge la compression JPEG sans perte, cependant les variantes de ce format ne sont pas pris en charge.

Reportez-vous au manuel de Déclaration de conformité DICOM du logiciel suiteDXT pour plus de détails sur les formats pris en charge.

Terminologie

Les termes « Danger », « Avertissement » et « Attention » apparaissent dans ce manuel pour indiquer les risques et désigner un degré ou niveau de gravité. Un risque est défini en tant que cause potentielle de blessure corporelle. Se familiariser avec les descriptions terminologiques répertoriées dans le tableau suivant :

Tableau 1: Terminologie en matière de sécurité

Graphique	Définition
 DANGER :	Le terme « Danger » est utilisé pour identifier des conditions ou actions qui représentent un risque particulier connu qui <u>provoquera</u> des blessures graves, la mort ou des dommages matériels importants si les consignes sont ignorées.
 AVERTISSEMENT :	Le terme « Avertissement » est utilisé pour identifier des conditions ou actions qui représentent un risque particulier connu qui <u>pourrait provoquer</u> des blessures graves, la mort ou des dommages matériels importants si les consignes sont ignorées.
 ATTENTION :	Le terme « Attention » est utilisé pour identifier des conditions ou actions qui représentent un risque potentiel connu qui <u>provoquera</u> ou <u>pourra</u> provoquer des blessures légères ou des dommages matériels si les consignes sont ignorées.

Dangers relatifs aux appareils



ATTENTION : L'utilisation d'un appareil endommagé ou dont l'état est compromis peut représenter un risque pour le patient car cela pourrait avoir pour effet de retarder son diagnostic. Il convient de veiller à ce que cet appareil soit en bon état de marche.



ATTENTION : Les applications fonctionnent sur un appareil comprenant un ou plusieurs disques durs, lesquels peuvent contenir des données médicales concernant des patients. Dans certains pays, ces appareils peuvent être sujets à une réglementation en matière de traitement des données personnelles et de libre circulation de ces données. Toute divulgation de données personnelles est susceptible d'entraîner des poursuites judiciaires en fonction de l'organisme de réglementation. Il est fortement recommandé de protéger l'accès aux fichiers qui concernent les patients. L'utilisateur est tenu de bien comprendre les lois qui régissent les questions relatives aux informations des patients.

Cybersécurité

NeoSoft prend les précautions suivantes en matière de cybersécurité dans la conception et le déploiement de son logiciel :


- L'administration, avec le logiciel NeoSoft, de certaines fonctions (permissions utilisateur, reconstruction de base de données, etc.) ne peut être réalisée que par des utilisateurs administratifs formés.
- Le logiciel NeoSoft est régulièrement analysé en quête de vulnérabilités listées dans la base de données et patché si nécessaire.
- Le logiciel NeoSoft utilise le standard DICOM pour sauvegarder les données patient et pour communiquer les données patient sur le réseau via un port utilisateur configuré.
- L'intégrité du logiciel NeoSoft avant installation est vérifiée par md5 sum afin de s'assurer que le logiciel a été livré entièrement intact.
- Le logiciel NeoSoft a été vérifié pour pouvoir être utilisé sur du matériel avec un chiffrement activé.
- NeoSoft limite les risques de conception liés à la cybersécurité en suivant la norme ISO 14971.
- Les employés NeoSoft reçoivent des formations sur la cybersécurité et la protection des informations médicales.
- NeoSoft ne reçoit ni ne gère les informations médicales protégées à moins que l'accès n'ait été spécifiquement accordé par un client pour dépannage.
- Le logiciel NeoSoft a subi un test de pénétration.
- Déconnexion automatique (ALOF) – suiteHEART peut être configuré pour se fermer après une durée prédéterminée de non-utilisation. suiteDXT reste ouvert jusqu'à fermeture par un utilisateur ou jusqu'au redémarrage du système.
- Contrôles d'audit (AUDT) – suiteHEART et suiteDXT produisent des journaux horodatés incluant des événements logiciels et des informations utilisateur.
- Autorisation (AUTH) – Dans suiteDXT, un administrateur peut visualiser et configurer le contrôle d'accès pour les autres utilisateurs. Selon le type de configuration de l'accès, les utilisateurs peuvent ne voir que certaines études dans suiteDXT et suiteHEART. Par exemple, l'utilisateur A peut n'avoir accès aux informations d'étude qu'à partir d'un emplacement A, tandis que l'utilisateur B peut avoir accès aux informations d'étude depuis les emplacements A et B.
- Authentification de nœud (NAUT) – suiteDXT peut être configuré pour communiquer avec d'autres appareils DICOM en configurant le titre AE, l'adresse IP, et le port DICOM. suiteHEART n'utilise pas le réseautage par défaut, mais peut être configuré pour envoyer des données vers d'autres systèmes à travers une modification de la configuration, en identifiant les autres systèmes par titre AE, adresse IP, et port. Les deux produits peuvent être utilisés sans réseautage en important les données d'études locales depuis le système de fichiers, au lieu d'envoyer ou de recevoir les études de données via un réseau.
- Authentification de personne (PAUT) – suiteDXT et suiteHEART peuvent être configurés pour autoriser l'authentification utilisateur, les contrôles de mot de passe de l'utilisateur, et la configuration des données patient disponibles spécifiques à l'utilisateur connecté. Les informations utilisateur sont exploitées.
- Capacités de connectivité (CONN) – suiteDXT peut se connecter aux autres partenaires DICOM configurés afin de transférer les données. suiteHEART peut être configuré pour envoyer des données vers d'autres systèmes à travers une modification de la configuration, en identifiant les autres systèmes par titre AE, adresse IP, et port.
- Verrous physiques (PLO) – Sans objet NeoSoft recommande l'usage de produits de sécurité réseau pour la protection.
- Renforcement système et application (SAHD) – Sans objet NeoSoft recommande l'usage de produits de sécurité réseau pour la protection.
- Anonymisation des données médicales (DIDT) – suiteDXT inclut une fonctionnalité « Anonymiser » pour anonymiser les études patient.
- Authenticité et intégrité des données médicales (IGAUI) – suiteDXT inclut des messages d'état de l'importation/du transfert des informations de l'étude qui confirment le succès du transfert/de l'importation, ainsi que la présence d'erreurs. suiteHEART alerte l'utilisateur via une fenêtre contextuelle si des données de saisie attendues sont manquantes ou corrompues.

- Sauvegarde des données et récupération après désastre (DTBK) – Il est recommandé d’envoyer les données générées par suiteHEART à PACS pour une sauvegarde/un stockage à long terme. suiteDXT inclut un outil de reconstruction de base des données au cas où le logiciel local s’avèrerait corrompu.
- Sauvegarde confidentielle des données médicales (STCF) – suiteHEART et suiteDXT sont destinés à être utilisés par du personnel qualifié et peuvent être sécurisés par nom d’utilisateur et mot de passe à la discrétion de l’utilisateur.
- Confidentialité de transmission (TXCF) – Tout transfert de données se fait au format DICOM.
- Intégrité de transmission (TXIG) – Tout transfert de données se fait au format DICOM.
- Mises à niveau cybersécurité du produit (CSUP) – Toute installation ou mise à niveau se fera sous la forme d’une nouvelle version logicielle prévue et appliquée à la discrétion du client.
- Nomenclature des matériels logiciel (SBoM) – L’écran « À propos » de suiteHEART énumère des logiciels tiers. Les informations sur ces logiciels tiers se trouvent dans le dossier d’installation de suiteDXT « 3pinfo. »
- Feuille de route pour les composants tiers dans le cycle de vie de l’appareil (RDMP) – NeoSoft évalue régulièrement les logiciels tiers et peut mettre à jour suiteHEART et/ou suiteDXT en cas de besoin.
- Directives sécuritaires (SGUD) – NeoSoft recommande l’usage d’un logiciel anti-virus.
- Configuration de la fonctionnalité de sécurité réseau (CNFS) –La capacité du produit à configurer les fonctions de sécurité réseau d’après les besoins utilisateur. Autant suiteHEART et suiteDXT peuvent être utilisés sans réseautage. Cependant, si une configuration pour transfert de réseau est effectuée, seuls le titre AE, l’adresse IP et les informations de port sont requises. Aucune sécurité supplémentaire n’est requise/recommandée.
- Accès d’urgence (EMRG) – Sans objet. suiteHEART et suiteDXT ne sont pas utilisés en situation d’urgence.
- Service distant (RMOT) – Le service peut être réalisé à distance via la méthode d’accès distant prescrite par le client (telle qu’un bureau distant). suiteHEART et suiteDXT n’incluent aucun accès à distance par eux-mêmes.
- Détection/protection contre les malwares (MLDP) – Sans objet. suiteHEART et suiteDXT n’incluent aucune détection ou protection contre les malwares. NeoSoft recommande l’usage de produits de sécurité réseau pour la protection.

Guide de démarrage

Fonctions de l'écran principal

FIGURE 1. Écran principal

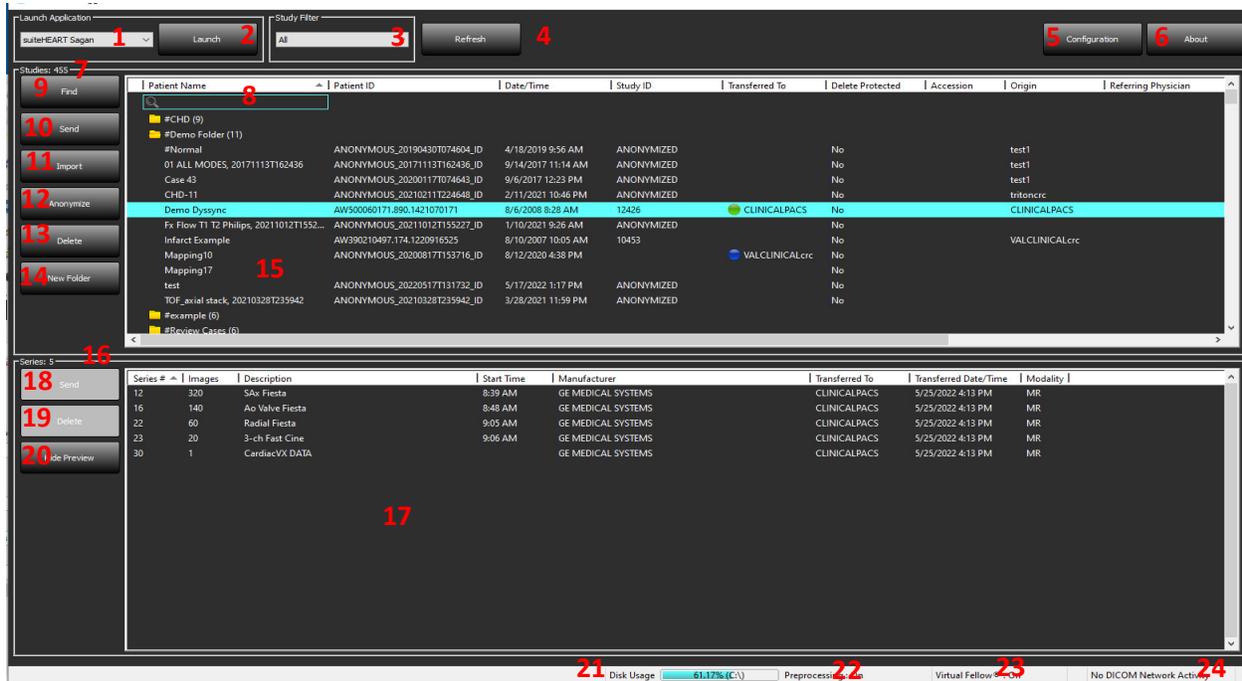


1. **Menu déroulant de lancement des applications** - énumère les applications configurées.
2. **Lancement** - lance les applications NeoSoft, LLC configurées.
3. **Filtre d'études** - définit la plage de dates pour lesquelles les études sont affichées dans la liste des études.
4. **Actualiser** - met à jour la vue en fonction des critères sélectionnés par l'utilisateur.
5. **Configuration** - ouvre la fenêtre de configuration.
6. **À propos** - affiche la version du logiciel suiteDXT et des liens vers les instructions d'utilisation. Déclaration de conformité DICOM et fichiers de consignation pour le support.
7. **Sommaire Études** - affiche le nombre d'études stockées sur le serveur local.
8. **Champ de recherche** - recherche automatiquement dans les colonnes, qu'elles soient triées ou non.
9. **Recherche** - ouvre la fenêtre Interrogation/Récupération.
10. **Envoyer** - envoie l'étude locale à un hôte distant.
11. **Importation** - permet d'importer les informations de l'étude à partir du système de fichier, d'un CD, d'un DVD ou d'un support USB.
12. **Anonymiser** - permet de créer une nouvelle étude pour laquelle certaines données patients seront masquées.
13. **Supprimer** - retire l'étude sélectionnée de la liste d'études suiteDXT et supprime les données DICOM du serveur local.
14. **Nouveau dossier** - crée un dossier pour organiser les études.
15. **Panneau Études** - affiche les informations relatives aux études stockées sur le serveur local.
 - Les titres des colonnes peuvent être réorganisés en cliquant et faisant glisser le titre de la colonne en question et triés en cliquant sur le titre de la colonne.

16. **Sommaire Séries** - affiche le nombre de séries d'une étude sélectionnée.
17. **Panneau Séries** - affiche les informations de séries d'une étude sélectionnée.
 - Les titres des colonnes peuvent être réorganisés en cliquant et faisant glisser le titre de la colonne en question et triés en cliquant sur le titre de la colonne.
18. **Envoyer** - envoie la série locale à un hôte distant.
19. **Supprimer** - supprime une série de l'étude sélectionnée et supprime les données DICOM.
20. **Afficher aperçu** - affiche un aperçu des séries de rapports suiteHEART Virtual Fellow™, CAS cine et CAS.
21. **Indicateur d'utilisation du disque** - affiche le pourcentage d'utilisation de l'espace du disque local pour les données des images.
22. **Statut du prétraitement** - indique le statut de configuration actuel du prétraitement (Activé/Désactivé).
23. **Indicateur du statut de Virtual Fellow®** - indique le statut de configuration actuel de Virtual Fellow™ (Activé/Désactivé).
24. **Statut réseau** - indique si suiteDXT est en train de transférer des données DICOM sur le réseau.

Menu activé avec un clic-droit dans le panneau Études


FIGURE 2. Menu activé par clic droit

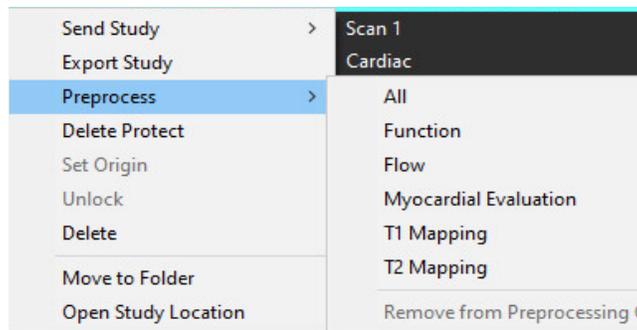

- **Envoyer étude** - envoie l'étude du serveur local à l'hôte distant. Peut être configuré pour n'envoyer que les séries NeoSoft DICOM. (Voir le Manuel d'installation)
- **Exporter étude** - enregistre les données de l'étude dans un fichier comprimé .zip.
- **Prétraitement** - assure le prétraitement de toutes les séries configurées ou uniquement pour Fonction, Flux, Évaluation du myocarde, Cartographie T1 et Cartographie T2 ; pour supprimer l'étude de la file d'attente, sélectionnez « Supprimer de la file d'attente de prétraitement ».
- **Protéger contre la suppression** - sert à indiquer si on a besoin de cette protection (Oui/Non).
- **Définir origine** - utilisé par votre administrateur réseau pour configurer le paramètre AE Title pour le contrôle de l'accès.
- **Déverrouiller** - réinitialise le verrou et ouvre une étude verrouillée suite à une panne du système.
- **Supprimer** - retire l'étude sélectionnée de la liste d'études suiteDXT et supprime les données DICOM du serveur local.
- **Déplacer vers dossier** - déplace une étude vers un dossier créé.
- **Ouvrir l'emplacement de l'étude** - affiche l'emplacement des données DICOM sur le système de fichier local.

REMARQUE : Le prétraitement n'est pas disponible pour l'application NeoSoft CAKE™.

Menu activé par clic droit dans le panneau Série




- **Envoyer** - envoie la série locale à un hôte distant.
- **Supprimer** - supprime une série de l'étude sélectionnée et supprime les données DICOM.
- **Détails** - ouvre la fenêtre des détails de la série.
- **Configurer prétraitement** - renseigne automatiquement le nom d'une série pour une série Fonction, Flux, Évaluation du myocarde, Cartographie T1 et Cartographie T2.

REMARQUE : La configuration du prétraitement n'est pas disponible pour l'application NeoSoft CAKE™.

Fenêtre Interrogation/Récupération

FIGURE 3. Fenêtre Interrogation/Récupération

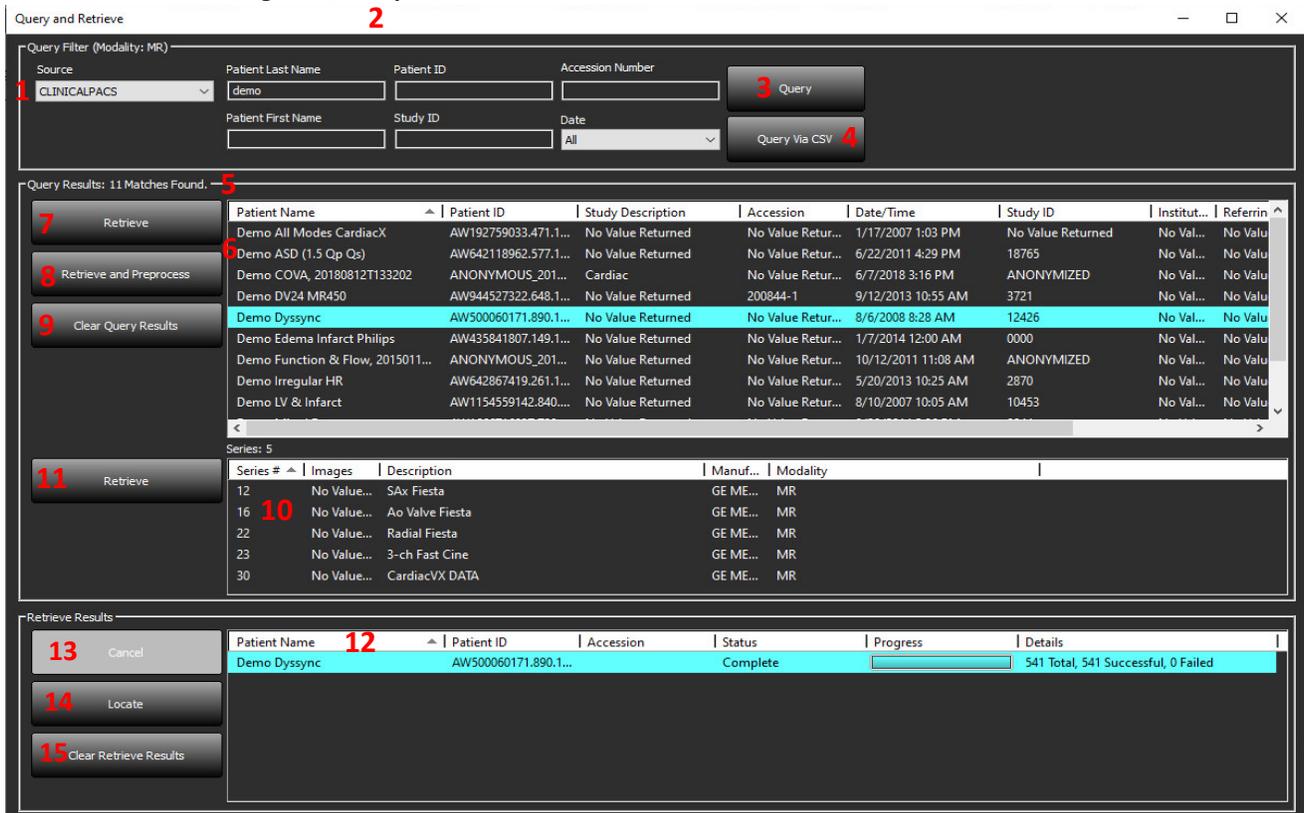

- Menu déroulant des sources d'interrogation** - affiche les dispositifs à distance configurés qui sont disponibles pour l'interrogation / la récupération.
- Filtre d'interrogation** - peut s'utiliser pour chercher une étude spécifique avec le prénom, le nom et l'identifiant du patient, l'identifiant de l'étude, le numéro d'acquisition et la date. L'astérisque (*) peut s'utiliser comme 'joker' pour n'importe quel champ (sauf la date).
- Interrogation** - interroge un dispositif à distance. Si tous les champs restent vides, l'interrogation ne produira pas de résultats.
- Interrogation via CSV** - interroge un dispositif à distance à l'aide d'un fichier CSV prédéfini.
- Résultats d'interrogation** - affichent toutes les études qui correspondent aux critères d'interrogation.
- Panneau des résultats d'interrogation** - affiche les informations d'étude du dispositif à distance interrogé.
 - Les titres des colonnes peuvent être réorganisés en cliquant et faisant glisser le titre de la colonne en question et triés en cliquant sur le titre de la colonne.
- Récupération** - exécute la récupération de l'étude à partir d'un dispositif à distance.
- Récupérer et prétraiter** - exécute la récupération et le prétraitement de l'étude sélectionnée à partir du dispositif à distance.
- Effacer les résultats d'interrogation** - efface les résultats d'interrogation dans le panneau de l'étude.
- Panneau Séries** - affiche les informations de séries de l'étude mise en surbrillance dans le panneau Études.
 - Les titres des colonnes peuvent être réorganisés en cliquant et faisant glisser le titre de la colonne en question et triés en cliquant sur le titre de la colonne.
- Récupération** - exécute la récupération de l'étude à partir d'un dispositif à distance.


12. **Panneau Statut du transfert** - affiche les actions de récupération en cours et terminées.
 - On peut réorganiser les titres de colonne en cliquant et faisant glisser le titre de la colonne en question.
13. **Annuler** - arrête l'activité de transfert.
14. **Localiser** - Surligne l'étude qui vient d'être récupérée dans le Volet Étude de l'interface principale.
15. **Effacer les résultats de récupération** - efface l'activité de transfert dans le panneau de transfert pour les études dont le transfert est terminé.



ATTENTION : Les images qui ont été transférées resteront locales et s'afficheront à l'écran principal de suiteDXT, même si toutes les images de l'étude n'ont pas été transférées.

Menu activé par clic droit dans le volet Interrogation/Résultats


FIGURE 4. Menu activé par clic droit



- **Récupérer** - exécute la récupération d'une étude à partir d'un hôte distant.
- **Récupérer et prétraiter** - exécute la récupération et le prétraitement de l'étude sélectionnée à partir de l'hôte distant.

Menu activé par clic droit dans le panneau Série

FIGURE 5. Menu activé par clic droit



- **Récupérer** - exécute la récupération d'une série à partir d'un hôte distant.


Utiliser suiteDXT

Lancer une application

Vous pouvez ajouter des applications en suivant les instructions du Manuel d'installation.

1. Allez à l'écran principal.
2. Dans le menu déroulant Lancement des applications, sélectionnez l'application souhaitée.

FIGURE 1. Lancer l'application

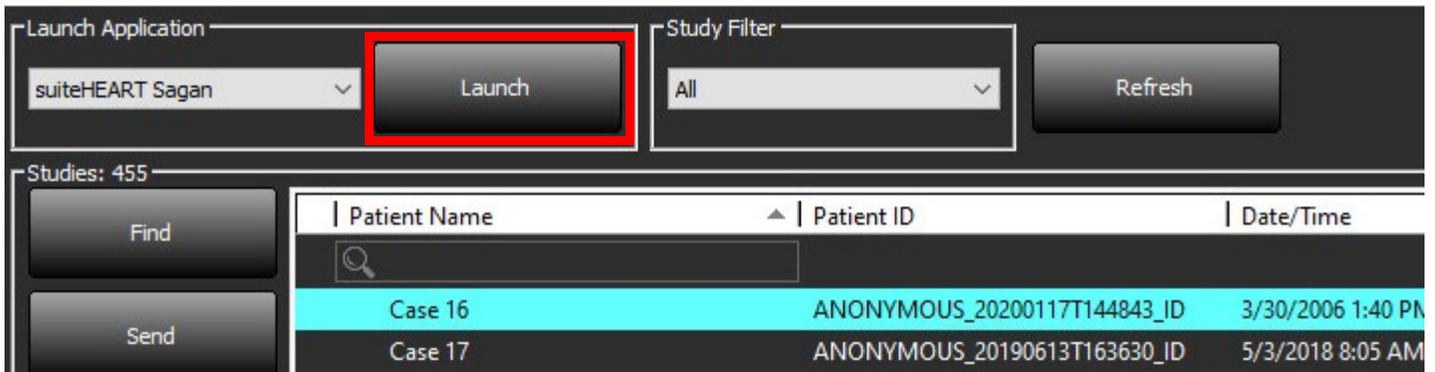


3. Sélectionner une étude dans la liste d'études et faire l'une des choses suivantes :
 - Sélectionner Lancement de l'application.
 - Double-cliquez sur l'étude.

Récupérer une étude hébergée sur un hôte distant

Les hôtes distants doivent avoir été configurés pour être accessibles. Pour de plus amples informations sur la façon de configurer un hôte distant, reportez-vous au Manuel d'installation.

1. Dans l'écran principal, cliquez sur le bouton Recherche.

FIGURE 2. Recherche sur l'écran principal

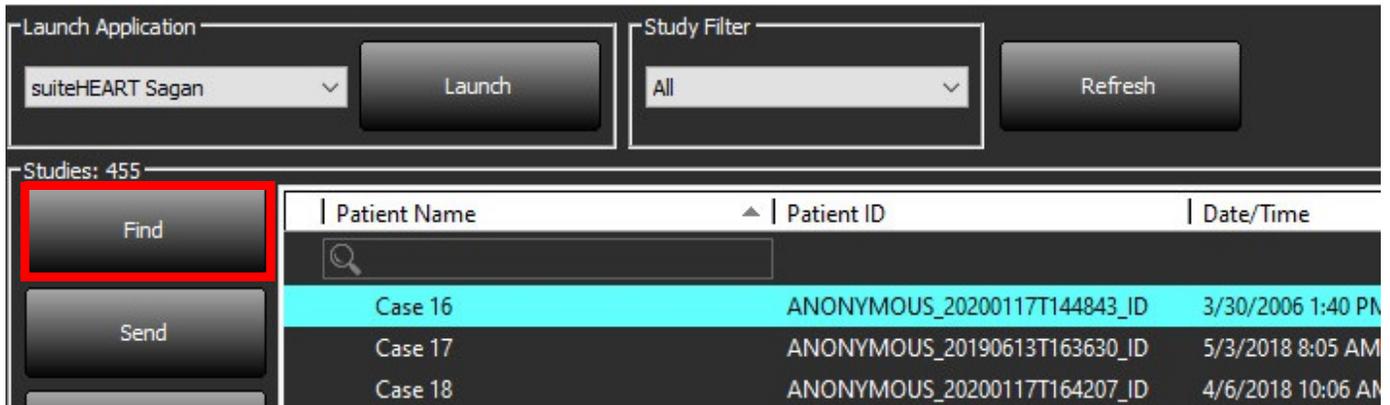


2. Dans la fenêtre =Interrogation/Récupération, saisissez les critères d'information de recherche dans la zone Filtre d'interrogation.

Les options de filtres sont :

- Nom du patient
- Prénom du patient
- ID du patient
- ID de l'étude
- Numéro d'acquisition
- Période

REMARQUE : La sélection Sauvegarde des filtres n'est disponible que si elle a été demandée auprès de Neosoft.

FIGURE 3. Fenêtre Interrogation/Récupération

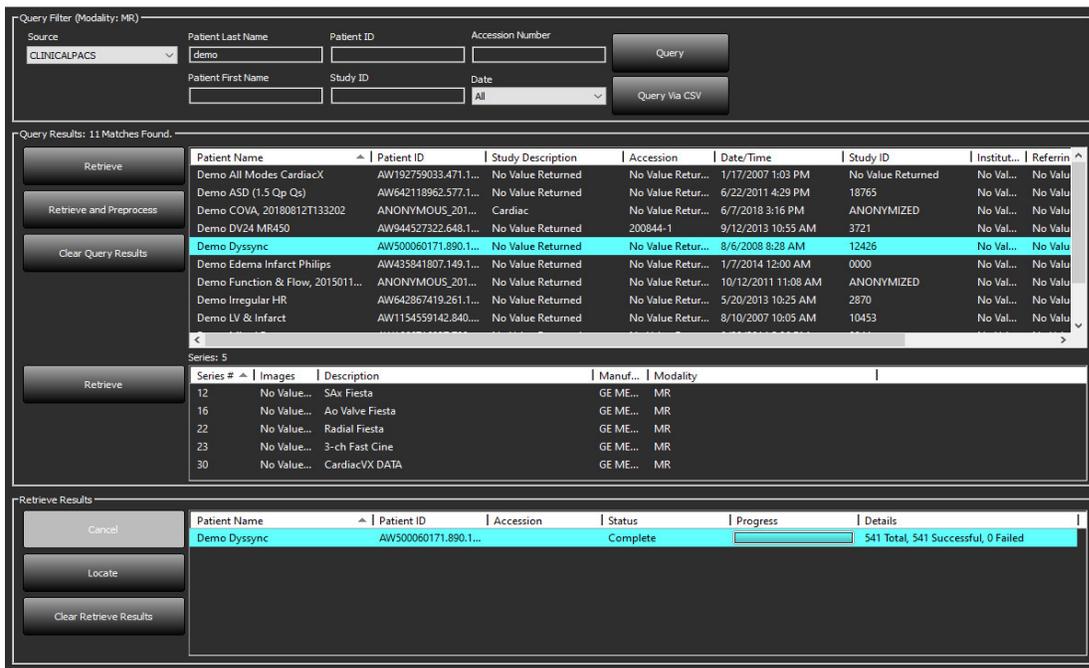

3. Dans le menu déroulant Source d'interrogation, sélectionnez l'hôte distant.
4. Sélectionnez Interrogation ou Interrogation via CSV.
5. Si vous exécutez une Interrogation via CSV, sélectionnez le fichier CSV.

Les études qui correspondent aux critères que vous avez indiqués ou provenant du fichier CSV apparaîtront dans la liste.

Lorsque vous cliquez sur une étude, une liste d'informations de série s'affiche.

REMARQUE : Pour exécuter une Interrogation via CSV, vous devez créer un fichier CSV. Vous pourrez trouver le modèle pour la création d'un fichier CSV sous C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\Import\Import_Template.csv

Le fichier CSV doit contenir les champs suivants :

Nom du patient	Prénom du patient	ID du patient	ID de l'étude	Date de l'étude AAAAmmjj	Numéro d'acquisition
----------------	-------------------	---------------	---------------	-----------------------------	----------------------

6. Sélectionnez une ou plusieurs étude(s).
 7. Sélectionnez Récupération qui se trouve en bas de la liste de l'étude ou cliquez à droite pour sélectionner Récupérer dans le menu contextuel.
 8. Effectuez le prétraitement en sélectionnant Récupérer et Prétraiter.
 9. Pour récupérer une série, sélectionnez la série voulue et cliquez sur Récupération en bas de la liste des séries.
- La progression de la récupération s'affiche dans la section Résultats de récupération, dans la partie inférieure de la fenêtre. Tandis qu'en bas de l'écran principal, le statut « Aucune activité de réseau DICOM » passe à « Réseau DICOM actif ».

REMARQUE : Si l'étude en question n'est que partiellement transférée, l'indicateur de progression devient rouge.

Récupération automatique d'une étude précédente

Les hôtes distants doivent avoir été configurés pour être accessibles. Pour de plus amples informations sur la façon de configurer un hôte distant, reportez-vous au Manuel d'installation. La configuration de la récupération automatique permettra de récupérer automatiquement les études précédentes dans la base de données DTX à partir d'un hôte distant tel que PACS.

Configuration de la destination à partir de laquelle effectuer la récupération des études précédentes :

REMARQUE : Il n'est possible de configurer qu'un seul hôte DICOM distant.

1. Dans l'écran principal, sélectionner le bouton Configuration.
2. Dans la section Destination DICOM, mettez en surbrillance le système PACS, puis cliquez sur « Modifier ».
3. Cochez PACS.
4. Sélectionnez le nombre d'études précédents à récupérer à l'aide du menu déroulant « Nombre max de précédents ». Renseignez des termes dans le champ Description de l'étude précédente. Ces termes permettent d'identifier l'étude à récupérer à l'aide du champ Description de l'étude. Les termes par défaut sont CARDIAQUE^COEUR.
5. Cliquez sur Mettre à jour
6. Cliquez sur « Appliquer » puis sur « Fermer ».

DICOM Device Configuration

Description: PACS1

AE Title: PACS1

Address: 172.16.0.3

Port: 4006

PACS

Max Priors: 1

Prior Study Description: CARDIAC^HEART

Enabled

Store to device

Query device

Preprocessing

Enable SSL


Auto Retrieve Prior Studies

DICOM Echo Update Cancel

Configuration des études devant générer des récupérations d'études précédentes

1. Dans l'écran principal, sélectionner le bouton Configuration.
2. Dans la section Destinations DICOM, sélectionnez les hôtes distants devant générer automatiquement une/des récupération(s) d'étude précédente en fonction de l'arrivée des études à partir de ces destinations en mettant la destination en surbrillance et en cliquant sur « Modifier ».
3. Cochez « Récupérer automatiquement les études précédentes ».
4. Cliquez sur Mettre à jour
5. Cliquez sur « Appliquer » puis sur « Fermer ».

REMARQUE : Si l'envoi du prétraitement est activé pour cette destination DICOM, le prétraitement de l'étude sera effectué si aucune donnée suiteHEART n'est présente.

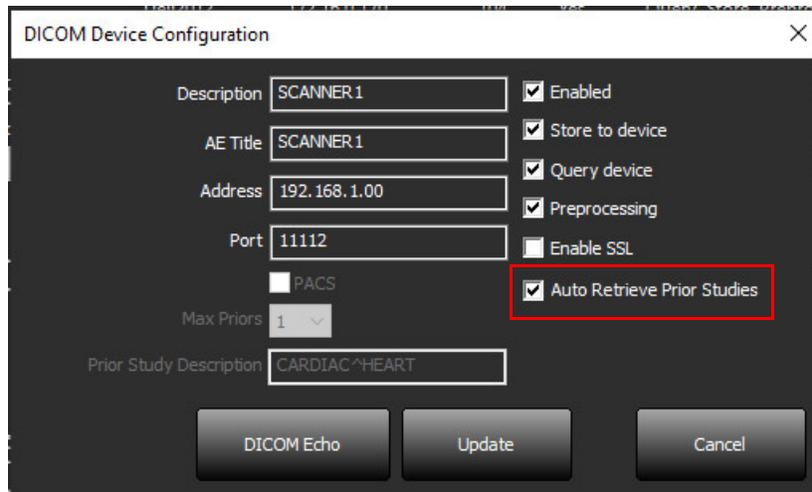

The image shows a 'DICOM Device Configuration' dialog box with the following fields and options:

- Description: SCANNER1
- AE Title: SCANNER1
- Address: 192.168.1.00
- Port: 11112
- Max Priors: 1
- Prior Study Description: CARDIAC^HEART
- Enabled:
- Store to device:
- Query device:
- Preprocessing:
- Enable SSL:
- Auto Retrieve Prior Studies: (highlighted with a red box)

Buttons at the bottom: DICOM Echo, Update, Cancel.

Envoyer une étude à un hôte distant

Les hôtes distants doivent avoir été configurés pour être accessibles. Pour de plus amples informations sur la façon de configurer un hôte distant, reportez-vous au Manuel d'installation.


REMARQUE : Le logiciel suiteDXT prend en charge la compression JPEG sans perte, cependant les variantes de ce format ne sont pas pris en charge.

1. Mettez en surbrillance l'étude à envoyer.
2. Sélectionnez Envoyer ou cliquez à droite pour sélectionner Envoyer étude dans le menu contextuel.
3. Sélectionnez la destination d'envoi.
4. Sélectionnez Envoyer dans la fenêtre contextuelle.

La fenêtre d'envoi DICOM affichera la progression du transfert. Vous pouvez fermer cette fenêtre en cliquant sur le X dans le coin du haut à droite ; le transfert se poursuivra en arrière-plan.


Pour vérifier la progression une fois la fenêtre d'envoi DICOM fermée, sélectionnez Envoyer, puis sélectionnez le Statut.

FIGURE 4. Fenêtre d'envoi DICOM

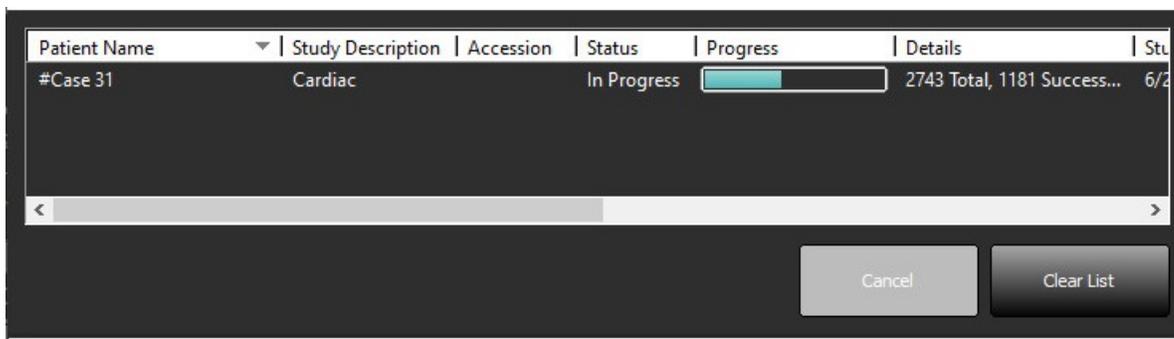

5. Les études qui ont été transférées indiquent l'hôte distant dans la colonne Transféré à de la liste d'études principale.

FIGURE 5. Transféré à

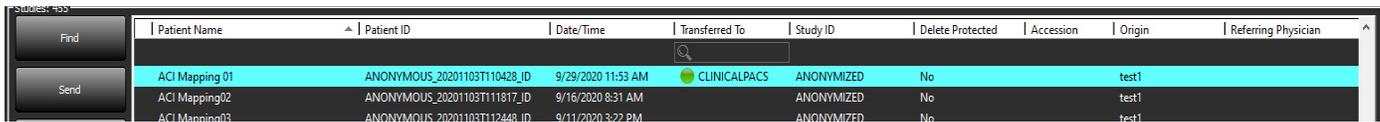The image shows a table with columns: 'Patient Name', 'Patient ID', 'Date/Time', 'Transféré à', 'Study ID', 'Delete Protected', 'Accession', 'Origin', and 'Referring Physician'. The first row is highlighted in blue and contains: 'ACI Mapping01', 'ANONYMOUS_20201103T110428_ID', '9/29/2020 11:53 AM', a green circle icon followed by 'CLINICALPACS', 'ANONYMIZED', 'No', and 'test1'. The second and third rows are not highlighted and contain similar data for 'ACI Mapping02' and 'ACI Mapping03'.

Envoyer une série à un hôte distant

1. Mettez l'étude en surbrillance.
2. Mettez la série à utiliser en surbrillance.
3. Sélectionnez Envoyer ou cliquez à droite pour sélectionner Envoyer dans le menu contextuel.
4. Sélectionnez la destination d'envoi.
5. Sélectionnez Envoyer dans la fenêtre contextuelle.
6. Les séries qui ont été transférées indiquent l'hôte distant dans la colonne Transféré à de la liste d'études principale.

FIGURE 6. Volet Transférer la série

Series #	Images	Description	Modality	Manufacturer	Transferred To	Transferred Date
101	50	Survey	MR	Philips Healthcare	CLINICALPACS	10/8/2020 12:52:32 PM
201	30	SSFP_AX	MR	Philips Healthcare	CLINICALPACS	10/8/2020 12:52:32 PM
301	30	BB_SSh_BH	MR	Philips Healthcare	CLINICALPACS	10/8/2020 12:52:32 PM


Indicateurs du volet Étude

Indicateur	État
Cercle bleu clair	Le transfert des images est incomplet ou les images ont été transférées sur plusieurs hôtes distants.
Cercle vert	Toutes les images de l'étude ont été transférées vers un hôte distant unique.

Envoyer des fichiers NeoSoft DICOM

Les fichiers qui sont créés par le logiciel peuvent être mis sur le réseau séparément. Reportez-vous au Manuel d'installation pour savoir comment configurer le système à cette fin.

1. Mettez l'étude en surbrillance.
2. Cliquez à droite sur l'étude et sélectionnez Envoyer NeoSoft DICOM.
3. Sélectionnez la destination DICOM.

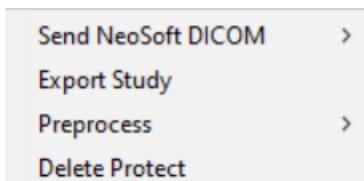

Importer une étude


Vous pouvez importer les études contenant des données DICOM à partir d'un système de fichiers local, de disques mappés, d'un CD, d'un DVD et d'un support USB ; y compris l'importation de dossiers zippés. Après avoir inséré le média contenant les données DICOM souhaitées, suivez les étapes indiquées ci-dessous.

REMARQUE : Le logiciel suiteDXT prend en charge la compression JPEG sans perte, cependant les variantes de ce format ne sont pas pris en charge.

1. Dans l'écran principal, sélectionnez Importer.
2. Localisez l'emplacement contenant les données DICOM.
3. Cliquez sur Sélectionner

La fenêtre de progression affiche le statut d'importation du fichier DICOM. Le récapitulatif d'importation affiche le nombre total de fichiers trouvés, les fichiers importés, le nombre d'études et les informations d'études importées.

Les études récemment importées sont ajoutées à la liste d'études affichée sur l'écran principal de suiteDXT. Si un dossier a été sélectionné, l'étude sera importée dans ce dossier.

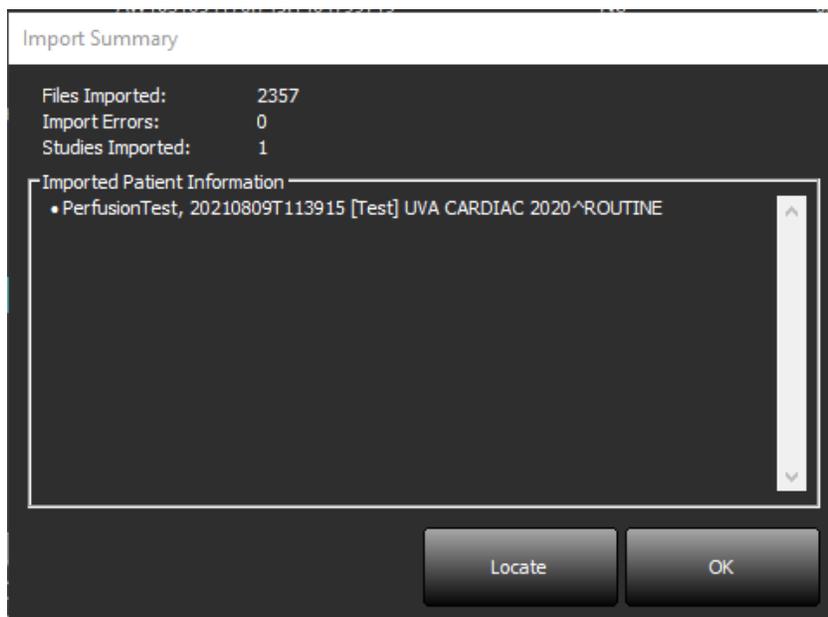

Vous pouvez importer les données fournies à titre d'exemple dans suiteDXT.

REMARQUE : Si l'étude n'est pas complètement importée, cliquez sur Réessayer sur l'écran Récapitulatif d'importation.

Exporter des études

Les études qui ont été analysées peuvent être exportées au format .zip à partir du répertoire d'études principal.

1. Personnalisez le nom de fichier en cliquant sur Configuration sur l'Écran principal.
2. Dans la section « Exporter modèle de noms de fichiers », sélectionnez les attributs de fichier souhaités, comme illustré dans la Figure 7.
3. Cliquez sur « Appliquer » puis sur « Fermer ».
4. Mettez en surbrillance l'étude ou le groupe d'études à exporter en utilisant les touches clavier [Ctrl]+[Maj].
5. Cliquez à droite et sélectionnez Exporter.
6. Sélectionnez l'emplacement approprié pour l'exportation.
7. Sélectionnez Enregistrer

FIGURE 7. Exporter modèle de noms de fichiers



Lancer une recherche

Il est possible de faire une recherche colonne par colonne automatiquement, que cette colonne soit triée ou non. La recherche n'est pas sensible à la casse et les résultats s'inscrivent automatiquement en haut de la liste.

Patient Name	Patient ID	Date/Time	Transferred To	Study ID	Delete Protected	Accession	Origin
Case							
SH Case 10	AW2091044406.251.1412004870	6/22/2011 4:29 PM		18765	No		tritoncr
SH Case 14, 20140929T165736	ANONYMOUS_20140929T165736_ID	8/10/2007 10:05 AM		ANONYMIZED	No		tritoncr

- Une fois que le premier résultat apparaît, appuyer sur la touche ENTRÉE du clavier ou sur la flèche du champ de recherche permet de passer d'un résultat au résultat suivant.
- Appuyer simultanément sur les touches ENTRÉE et MAJ. du clavier permet de passer d'un résultat au résultat précédent.
- Une fois arrivé au dernier résultat, appuyer sur la touche ENTRÉE du clavier, avec ou sans appuyer sur MAJ. simultanément remettra le curseur sur le premier résultat.
- Le champ de recherche s'effacera si vous appuyez sur .


REMARQUE : Pour que la recherche inclue les dossiers dans la liste des études, il faut détailler ces derniers. Cliquez à droite sur le dossier voulu et sélectionnez Tout détailler.

Créer des dossiers

Il est possible de créer des dossiers pour organiser des études au niveau de la liste des études. Ils seront regroupés en haut de la liste d'études.


1. Cliquez sur Nouveau dossier.
2. Entrez un nom de dossier et cliquez sur Enregistrer.

Le dossier sera placé dans la liste des études.

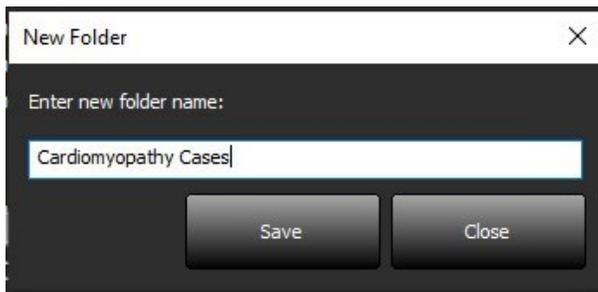

3. Pour déplacer une étude dans le dossier, cliquez à droite sur l'étude et sélectionnez Déplacer vers dossier.
4. Lorsque la boîte de dialogue Dossier s'ouvre, sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez placer l'étude.

FIGURE 8. Options de dossiers

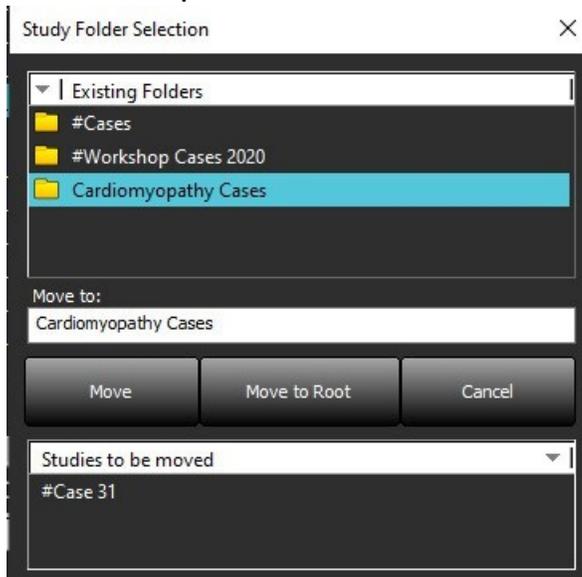

5. Pour replacer une étude dans le répertoire principal, cliquez à droite sur l'étude et sélectionnez Déplacer vers dossier.
6. Cliquez sur Déplacer vers racine

Anonymiser une étude



ATTENTION : L'anonymisation d'une étude ne supprime pas les données du patient des images qui ont été créées à partir d'autres logiciels de post-traitement.



ATTENTION : L'étude anonymisée doit être utilisée uniquement avec des applications NeoSoft, LLC.

1. Dans l'écran principal, sélectionnez l'étude à anonymiser.
2. Sélectionnez Rendre anonyme.
3. Remplissez les champs d'anonymisation illustré sur la Figure 9.
4. Pour ne pas inclure la série de capture secondaire, désélectionnez l'option.
5. Cliquez sur Anonymiser.

FIGURE 9. Anonymiser l'étude

Un indicateur de progression s'affichera. L'étude que vous venez d'anonymiser apparaîtra dans la liste d'études intitulée :

6. Cliquez sur « OK » dans la fenêtre contextuelle Anonymiser étude.

REMARQUE : La fonction d'anonymisation existe pour permettre une assistance technique de la part de NeoSoft.

Supprimer une protection

Pour supprimer la protection d'une étude, cliquez à droite sur l'étude, puis sélectionnez Supprimer la protection. La colonne des indicateurs affichera « Oui » pour les études qui sont protégées et « Non » pour celles qui ne le sont pas, comme illustré en Figure 10. Pour désactiver la protection, cliquez à droite sur l'étude et sélectionnez Supprimer la protection contre la suppression.

FIGURE 10. Indicateur de la colonne Protection contre la suppression

Patient Name	Patient ID	Date/Time	Transferred To	Delete Protected	Study ID
SH Case 21	AW712995506.906.1442511336	9/12/2013 10:55 AM		Yes	3721
SH Case 22	AW1908138422.466.1442956310	12/16/2013 10:28 AM		Yes	MCARD
SH Case 23, 20150819T112311	ANONYMOUS_20150819T112311_ID	1/13/2014 12:00 AM	test1	No	ANONYMIZED
SH Case 24, 20161030T104233	ANONYMOUS_20161030T104233_ID	12/16/2014 11:30 AM		No	ANONYMIZED

Supprimer une étude



ATTENTION : La suppression de données du système de fichiers, y compris les fichiers pour l'étude en cours, peut entraîner une perte des données d'analyse/ d'image.

À partir de l'écran principal, sélectionnez l'étude à supprimer, puis Supprimer, ou bien cliquez à droite et sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel. Plusieurs études de la liste sont sélectionnées pour suppression lorsque l'on appuie simultanément sur Maj. et le bouton gauche de la souris, ou sur Ctrl et le bouton gauche de la souris.

Supprimer une série

Sur l'écran principal, sélectionnez l'étude, puis la série, et cliquez ensuite sur Supprimer. À l'aide des commandes [Maj. + clic] ou [Ctrl + clic], vous pouvez sélectionner plusieurs séries dans la liste.

REMARQUE : Nous recommandons de faire la suppression des séries avant de commencer l'analyse.

Supprimer une série de capture secondaire

Il est possible de supprimer une série de capture secondaire dont le fabricant est identifié comme étant NeoSoft, LLC.



ATTENTION : La suppression de la série de données suiteHEART effacera tous les résultats d'analyse.

1. Sélectionnez l'étude et localisez la série suiteHEART DATA.
2. Cliquez sur le numéro de la série ou sur l'icône + pour ouvrir la fenêtre Détails de la série.

FIGURE 11. Sélection de série

Send	Series # ^	Images	Description	Start Time	Manufacturer	Transferred To	Transferred Date/Time	Modality
	3200	9	[Loc: -63.99] + C SMARTIMap FIESTA	10:50 AM	GE MEDICAL SYSTEMS			MR
	3210	9	[Loc: -77.54] + C SMARTIMap FIESTA	10:50 AM	GE MEDICAL SYSTEMS			MR
Delete	3220	9	[Loc: -91.09] + C SMARTIMap FIESTA	10:50 AM	GE MEDICAL SYSTEMS			MR
Show Preview	3500	14	MAG:2D PSMDE	10:55 AM	GE MEDICAL SYSTEMS			MR
	3600	3	MAG:2D PSMDE	11:02 AM	GE MEDICAL SYSTEMS			MR
	3700	3	MAG:2D PSMDE	11:03 AM	GE MEDICAL SYSTEMS			MR
	3701	1	CAS_SCPT_SERIES AUTO_T1_MOLL1_1		NeoSoft LLC			MR
	3702	1	CAS_SCPT_SERIES AUTO_T1_SMART_1		NeoSoft LLC			MR
	3703	1	CAS_SCPT_SERIES AUTO_T1_SMART_2		NeoSoft LLC			MR
	3713	2	suiteHEART DATA		NeoSoft LLC			MR
	3716	20	SAx Fiesta		NeoSoft LLC			MR
	3717	1	RS:2D PSMDE		NeoSoft LLC			MR

3. Sélectionnez la ligne voulue, cliquez sur Supprimer. Pour fermer, cliquez sur le X situé dans le coin en haut à droite de la fenêtre ou cliquez sur **Fermer**.

FIGURE 12. Détails de la série

Series Details ×

Description: [suiteHEART DATA] Number: [3713] Modality: [MR] Manufacturer: [NeoSoft LLC]

SOP Instance UID	Date/Time	Number ^
1.2.826.0.1.3680043.9.1400.2.1653576577.400	5/26/2022 9:49 AM	1
1.2.826.0.1.3680043.9.1400.5.1653576676.605	5/26/2022 9:51 AM	2

Delete Close

À propos de suiteDXT

Cliquer sur l'option À propos de l'écran principal affichera la version de suiteDXT.

Cliquez sur le lien « Instructions relatives à l'utilisation » pour lancer les Instructions d'utilisation.

Cliquez sur le lien « Déclaration de conformité DICOM » pour ouvrir le document de Déclaration de conformité DICOM.

REMARQUE : L'ouverture de ces documents requiert un lecteur PDF.

REMARQUE : Cliquez sur « Archiver fichiers de consignation par précaution » pour créer un fichier que le service technique pourra utiliser pour le dépannage.

FIGURE 13. Écran À propos



Prétraitement d'étude

REMARQUE : Cette section ne s'applique pas à l'application NeoSoft CAKE™.

La fonctionnalité de prétraitement d'étude est uniquement disponible avec le logiciel suiteHEART®. Cette fonctionnalité permet d'assurer le prétraitement pour Fonction, Flux, Évaluation du myocarde, Cartographie T1 et Cartographie T2. Il est possible d'utiliser la fonctionnalité de prétraitement avec la fonctionnalité Virtual Fellow™.


REMARQUE : Le prétraitement sera désactivé si le matériel ne répond pas aux exigences minimales du système.

Configurer le pré-traitement

1. Dans l'écran principal, sélectionner le bouton Configuration.
2. Dans la section Prétraitement, cochez « Activer l'auto-détection » pour chaque type d'application.

REMARQUE : L'auto-détection peut être désactivée en définissant le nom de la série. Consultez Définir les descriptions de série ci-dessous.


3. Pour la Cartographie T1 et T2, sélectionnez le type de série de Série temporelle ou de mappage.
4. Cocher « Enable Virtual Fellow™ » (Activer Virtual Fellow™) pour effectuer une optimisation d'image.
5. Cochez « Mise à jour automatique » pour permettre le lancement de l'étude avec traitement effectué en arrière-plan.
6. Cliquez sur « Appliquer » puis sur « Fermer ».

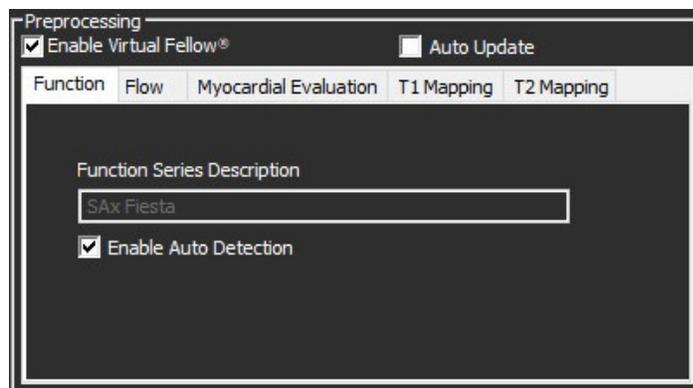

Définir les descriptions de série

1. À partir de l'écran principal, sélectionnez une étude dans le volet Études.
2. Sélectionnez une série dans le volet Séries.
3. Effectuez un clic droit sur le nom de la série, puis sélectionnez le type d'analyse approprié pour cette série.

Le nom de la série sera automatiquement renseigné dans la section Prétraitement.

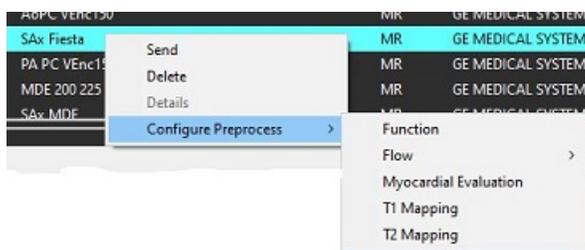

4. Renouvelez l'opération pour tous les types de séries.

Utiliser le prétraitement


Le prétraitement peut être effectué pour les études d'IRM cardiaques envoyées directement à suiteDXT à partir d'un autre nœud DICOM.

REMARQUE : Lorsque Mise à jour automatique est activée, les études peuvent être lancées avec traitement effectué en arrière-plan.

Le prétraitement peut être initié de la façon suivante :

Volet Étude

1. Sélectionnez un patient dans le volet Étude.
2. Cliquez à droite et choisissez Prétraitement dans le menu.

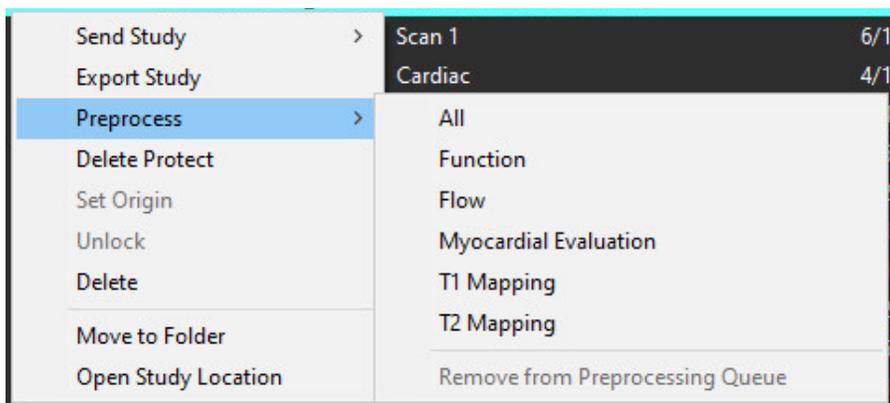


Fenêtre Interrogation/Récupération

Consultez les sections Interrogation/Récupération dans « Guide de démarrage » et « Utiliser suiteDXT ».

Nœud DICOM envoyé à suiteDXT

1. Dans l'écran principal, sélectionner le bouton Configuration.
2. Dans la section Destination DICOM, sélectionnez le nœud DICOM, puis cliquez sur « Modifier ».
3. Cochez « Prétraitement »
4. Cliquez sur Mettre à jour
5. Cliquez sur « Appliquer » puis sur « Fermer ».

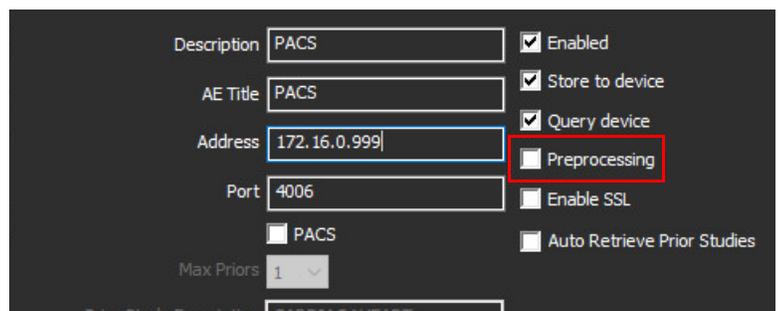

Lorsque « Prétraitement » est coché et que le prétraitement a été configuré, un indicateur « Prétraitement : Activé » s'affiche dans le volet État.



Indicateurs du volet Étude


Indicateur	État
Cercle bleu clair	L'étude est en cours de prétraitement.
Cercle bleu foncé	L'étude est dans la file d'attente.
Cercle vert	Le prétraitement est terminé. L'indicateur reste à l'écran jusqu'à ce que l'étude soit ouverte.
Cercle rouge	Le prétraitement n'a pas fonctionné. Contacter NeoSoft par e-mail à l'adresse suivante : service@neosoftmedical.com .

	Patient Name	Patient ID	Date/Time	Transferred To	Delete Protected	Study ID	Access
Find	SH Case 31_20161027T111015	ANONYMOUS_20161027T111015_ID	4/5/2016 2:46 PM		No	ANONYMIZED	
Send	SH Case 33_20171006T105644	ANONYMOUS_20171006T105644_ID	7/6/2017 10:15 AM		No	ANONYMIZED	
Import	SH Case 37_20190518T140428	ANONYMOUS_20190518T140428_ID	6/10/2016 11:52 AM		No	ANONYMIZED	
	SH Case 38	ANONYMOUS_20210126T145814_ID	8/11/2020 8:36 AM		No	ANONYMIZED	
	SH Case 39	ANONYMOUS_20210303T144600_ID	6/21/2017 1:34 PM		No	ANONYMIZED	
	SH Case 40	ANONYMOUS_20210303T144600_ID	1/20/2017 12:46 PM		No	ANONYMIZED	

Activer/désactiver Virtual Fellow™

1. Dans l'écran principal de suiteDXT, sélectionnez Configuration.
2. Dans la section Prétraitement, cochez « Activer Virtual Fellow™ » pour effectuer une optimisation d'image.
3. Cliquez sur « Appliquer » puis sur « Fermer ».

FIGURE 1. Configuration du prétraitement

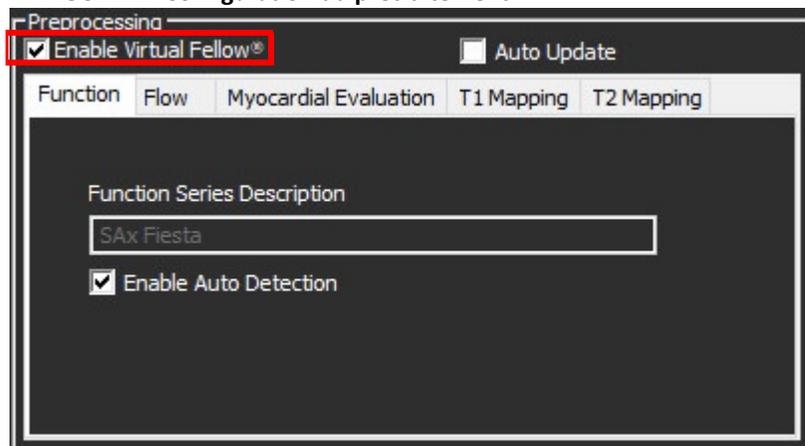

Fenêtre Aperçu de l'image



AVERTISSEMENT : Les images ne sont pas utilisables pour le diagnostic ou le traitement.

Dans l'écran principal de suiteDXT, affichez ou masquez la fenêtre Aperçu.

REMARQUE : Si l'étude sélectionnée contient des séries de rapports suiteHEART Virtual Fellow™, CAS Cine et/ou CAS, ces séries s'afficheront automatiquement dans la fenêtre d'aperçu, comme illustré dans la Figure 2.

FIGURE 2.

Study #	Patient Name	Patient ID	Date/Time	Transfer
54 Case 26	201807110660	AVICHHAROUS_2018020710660_ID	10/06/2018 4:11 PM	
54 Case 27	201807110657	AVICHHAROUS_2018020710657_ID	8/26/2018 4:11 PM	
54 Case 28 (40)	2018020710650	AVICHHAROUS_2018020710650_ID	10/4/2018 3:31 PM	
54 Case 30	201807110700	AVICHHAROUS_2018020710700_ID	10/7/2018 12:11 PM	
54 Case 31	2018020710645	AVICHHAROUS_2018020710645_ID	4/3/2018 2:48 PM	
54 Case 33	2017080710644	AVICHHAROUS_2017080710644_ID	7/12/2017 10:15 AM	
54 Case 37	201807110628	AVICHHAROUS_201807110628_ID	8/19/2018 11:52 AM	
54 Case 38		AVICHHAROUS_2018020710684_ID	8/11/2018 8:30 AM	
54 Case 39		AVICHHAROUS_2018020710680_ID	8/21/2017 1:18 PM	
54 Case 40		AVICHHAROUS_2018020710694_ID	9/28/2017 12:46 PM	
54 Case 41		AVICHHAROUS_2018020710686_ID	3/28/2018 8:30 AM	
54 Case 42		AVICHHAROUS_2018020710689_ID	11/22/2018 6:17 PM	
54 Case 43		AVICHHAROUS_2018020710688_ID	12/6/2018 1:21 AM	
54 Case 44		AVICHHAROUS_2018020710691_ID	11/12/2017 10:56 AM	

Series #	Images	Description	Start Time	Manufacturer
1000	9	[cas-0189] - C SMARTMap FESTA	10:30 AM	GE MEDICAL SYSTEMS
1110	9	[cas-0254] - C SMARTMap FESTA	10:30 AM	GE MEDICAL SYSTEMS
1120	9	[cas-0189] - C SMARTMap FESTA	10:30 AM	GE MEDICAL SYSTEMS
1500	14	HA-0120 PS-HIDE	10:11 AM	GE MEDICAL SYSTEMS
1600	1	HA-0120 PS-HIDE	11:01 AM	GE MEDICAL SYSTEMS
1700	5	HA-0120 PS-HIDE	11:01 AM	GE MEDICAL SYSTEMS
1701	1	CAS_SCRIPT_SERIES_AUTO_T1_MOLLI_1		ViewSoft LLC
1702	1	CAS_SCRIPT_SERIES_AUTO_T1_SMART_1		ViewSoft LLC
1703	1	CAS_SCRIPT_SERIES_AUTO_T1_SMART_2		ViewSoft LLC
1710	2	casHEART DATA		ViewSoft LLC
1716	20	SAR FESTA		ViewSoft LLC
1717	1	PS-00 PS-HIDE		ViewSoft LLC
1718	1	HA-0120 PS-HIDE		ViewSoft LLC


Assistance technique

Panne du réseau DICOM

En cas d'échec de récupération pendant le transfert d'une étude, assurez-vous qu'un firewall n'est pas la cause de cet échec. Si le problème ne provient pas d'un firewall, assurez-vous que suiteDXT peut sonder l'hôte distant par écho DICOM et que l'hôte distant peut sonder suiteDXT par écho DICOM.

1. Dans l'écran principal, sélectionnez Configuration.
2. Dans la section Configuration DICOM, sélectionnez l'hôte distant à partir duquel vous avez tenté une récupération et sélectionnez « Modifier ».
3. Cochez les cases suivantes : Autoriser, Stocker dans appareil et Dispositif d'interrogation.
4. Vérifiez que l'adresse IP, le port et le titre AE de la destination DICOM sont corrects.

FIGURE 1. Fenêtre Configuration DICOM

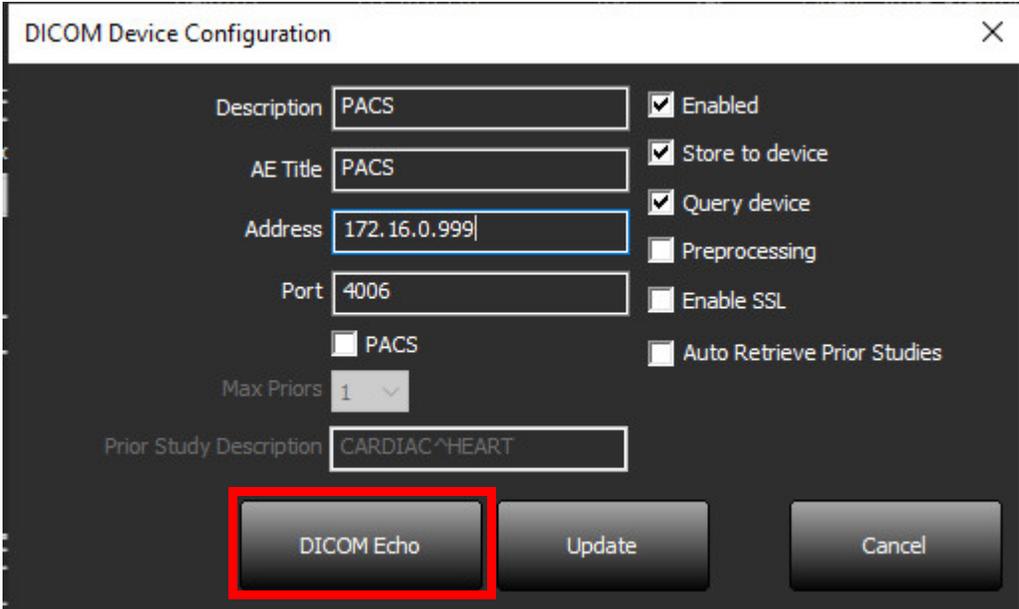

DICOM Device Configuration

Description PACS Enabled

AE Title PACS Store to device

Address 172.16.0.999 Query device

Port 4006 Preprocessing

PACS Enable SSL

Max Priors 1 Auto Retrieve Prior Studies

Prior Study Description CARDIAC^HEART

DICOM Echo Update Cancel

5. Sélectionnez Écho DICOM.
6. Consulter les paramètres de réseau et s'assurer que le port sélectionné est ouvert et accessible sur l'hôte suiteDXT.
7. Effectuez à nouveau la récupération de l'étude.


Si, après avoir suivi les étapes précédemment indiquées, la récupération échoue à nouveau, contactez votre administrateur de réseau.

Erreur de lancement de l'étude

Si le message « Les études suivantes sont verrouillées et ne seront pas chargées pendant le lancement » s'affiche lorsque vous essayez de lancer une étude, procédez comme suit :

1. Accédez au répertoire des études de suiteDXT.
2. Effectuez un clic droit sur l'étude qui a généré le message d'erreur.
3. Sélectionner « Déverrouiller ».

FIGURE 2. Déverrouiller une étude

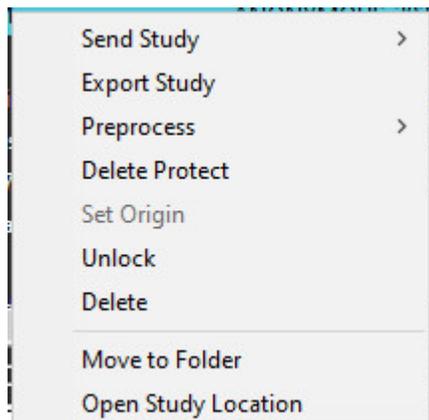

Nous contacter

Si vous rencontrez des difficultés pendant l'installation ou l'utilisation de suiteDXT, veuillez contacter l'assistance technique de NeoSoft, LLC à l'adresse suivante : service@NeoSoftmedical.com.